＊＊2010年3月 8 日改訂（第５版）
＊2008年8月18日改訂（第４版）

製　品　番　号	3415
医療機器届出番号	27B1X00106000001

類別：器49．医療用穿刺器、穿削器及び穿孔器
一般的名称：採血用穿刺器具　JMDNコード：70226000
一般医療機器

販売名：マイクロレット　チョイス

【禁忌・禁止】
個人の使用に限り、複数の患者に使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】
（各部の名称）

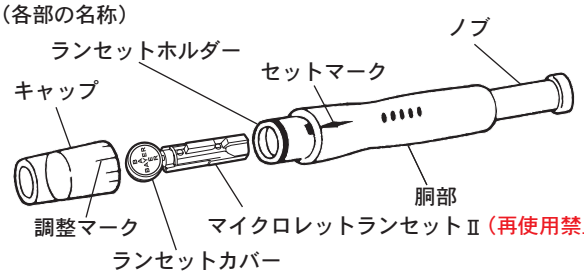

［作動・動作原理］
キャップを皮膚に押し当て、ノブが完全に止まる位置まで押し込んだ後、ノブを元の位置に戻すことによりキャップ内が減圧され血液が吸引される。

【使用目的・効能又は効果】
血糖測定時に少量の毛細管血を指頭、耳朶、足踵以外から採血するための減圧式の採血器である。

【操作方法又は使用方法等】
①採血部位を洗浄する。
手のひらの小指の下部や前腕を採血部位とする場合には石鹸と温水で良く洗い、タオル等で水分をふき取り、乾燥させる。腹部、太もも等洗浄しにくい部位から採血する場合にはアルコール消毒綿を使って消毒する。
②キャップをねじりながら胴部より外す。
③ランセットの先端のランセットカバーを1～2回転ほどひねる。マイクロレット　チョイスに装着が完了するまでランセットカバーを針先から切り離さないこと。
④ランセットを本器のランセットホルダーに完全に止まる位置までしっかりと押し込み装着する。ランセットカバーを針先からひねり取り針先を露出させる。ひねり取ったランセットカバーはランセットを破棄する時に再度針先にはめ込むため捨てないこと。
⑤キャップを装着する。キャップを回転させることにより、穿刺の深さを調節可能である。調整マークの一番長い線では最も深く、短くなるに従い穿刺の深さが浅くなる。
⑥穿刺部位にマイクロレット　チョイスの先端（キャップ）部分を強く押しあてノブを押す。
⑦血液を吸引するため、先端部分を密着させたままノブを元の位置まで戻し、押しあてていた力をゆるめる。皮膚が盛り上がり、血液が出始める。
⑧米粒大の血液が滴状に出たことを確認後、皮膚の盛り上がりが無くなり自然に離れるまで再度ノブをゆっくり押す。
⑨皮膚の盛り上がりが無くなったら、本体を横に倒すようにして、静かに皮膚から離す。
⑩キャップを外し、ひねり取ったランセットカバーを針先にかぶせたのち、ランセットホルダーから使用済みのランセットを抜き取り所定の場所に捨てる。ランセットは使い捨て製品であるので再使用できない。

＊＊【使用上の注意】
１．重要な基本的注意
①包装が破損、汚損している場合や、製品に破損などの異常が認められる場合は使用しないこと。
②マイクロレット　チョイスはマイクロレットランセットⅡ以外のランセットを使用しないこと。
③マイクロレットランセットⅡは滅菌品である。感染の危険があるので、再使用しないこと。
④マイクロレットランセットⅡの装着時、ランセットカバーを1～2回転ほどひねる。マイクロレット　チョイスに装着が完了するまでランセットカバーを針先から切り離さないこと。ひねり取ったランセットカバーはランセットを廃棄する時に再度針先にはめ込むため捨てないこと。
⑤ランセットカバーを一旦外した後は、速やかに使用すること。
⑥使用済マイクロレットランセットⅡは必ずランセットカバーを付け、所定の廃棄方法にしたがって廃棄すること。
⑦静脈血管の上を穿刺しないこと。
⑧指頭、耳朶、足踵からの採血にはむかない。
⑨出血させた穿刺部位に手が触れてはならない。
⑩組織が薄い部位への穿刺を行うと、組織を貫通した針で指を穿刺し、血液を介した感染のおそれがあるため、添付文書上にある穿刺部位を守ること。
２．その他の注意
①血糖自己測定は必ず医師の指導に従って実施すること。
②マイクロレット　チョイスが故障した場合は直ちに使用を中止し、医療機関または弊社まで連絡すること。
③マイクロレット　チョイスは取扱操作説明書に従って洗浄すること。
④採血前に採血部位を洗浄・消毒すること。
⑤ランセットカバーを外す際や装着時には、針刺し事故が生じないよう慎重に行うこと。
⑥マイクロレット　チョイス本体・キャップなどに血液が付着した場合には取扱操作説明書の方法に従って洗浄し、各施設で採用している感染防止手順に従うこと。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】
小児の手の届かないところに保管する。

【保守・点検に係る事項】
マイクロレット　チョイス用キャップ及びマイクロレット　チョイスの各部を取扱操作説明書に従って洗浄すること。

【包　装】
マイクロレット　チョイス　１個

【文献請求先・問い合わせ先】
バイエル薬品株式会社　糖尿病検査お問い合わせコーナー
電話：0120-123119（フリーダイヤル）

＊【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】
バイエル薬品株式会社
大阪市北区梅田二丁目4番9号

製造業者名：株式会社　旭ポリスライダー

取扱説明書をよくお読みください

輸入
57045020